

Pasos para la autoinyección de Cetrotide® (acetato de cetorelix inyectable) 0.25 mg



Antes de inyectarse Cetrotide®, lea atentamente las siguientes instrucciones.

PREPARACIÓN:

Antes de comenzar




1. Lávese bien las manos con agua y jabón.

2. Coloque todo lo que necesita sobre una superficie plana y limpia:


Nota: el kit no incluye todo el material.

Disuelva el polvo de Cetrotide® únicamente con el agua que contiene la jeringa precargada. No use la solución de Cetrotide® si contiene partículas o si no es transparente.


Mezcle el polvo y el agua para preparar el medicamento

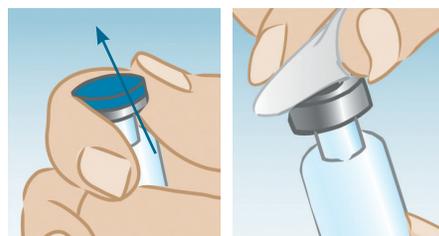


3. Retire la cubierta de plástico del vial. Limpie el anillo de aluminio y el tapón de goma con una toallita con alcohol.

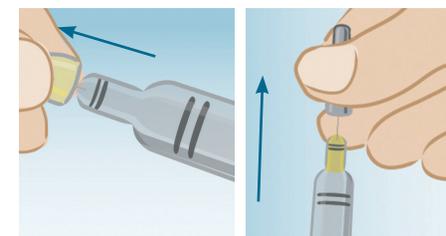

4. Tome la aguja mezcladora con la marca **amarilla** y retire el envoltorio. Tome la jeringa precargada y retire la cubierta. Gire la aguja de la jeringa y retire la cubierta de la aguja.

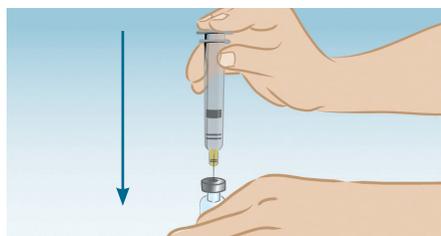

5. Empuje la aguja hacia abajo a través del centro del tapón de goma del vial. Inyecte el agua estéril en el vial presionando lentamente hacia abajo el émbolo de la jeringa.

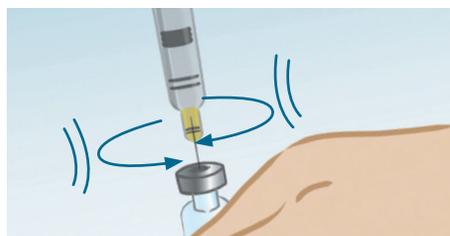


6. Deje la jeringa en el vial. Mueva el vial haciendo espirales suaves hasta que la solución se vuelva transparente y no tenga residuos. Evite que se formen burbujas durante la disolución.

NOTA: cuando el contenido esté mezclado, se verá claro y sin partículas. NO lo agite, ya que puede producir burbujas en su medicamento.



7. Llene la jeringa con todo el contenido del vial. Si queda líquido en el vial, dé vuelta al vial y tire de la aguja hacia atrás hasta que la abertura de la aguja se encuentre justo dentro del tapón. Si mira de lado a través del espacio en el tapón, podrá controlar el movimiento de la aguja y el líquido.

Es importante que retire todo el contenido del vial.

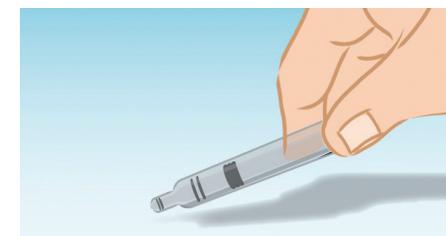

8. Separe la aguja de la jeringa y deje a un lado la aguja.

Importante

Almacenamiento: Cetrotide® (acetato de cetorelix para inyección) 0.25 mg debe almacenarse refrigerado (36 a 46 °F/de 2 a 8 °C) hasta la fecha de vencimiento. Protéjalo de la luz. Utilícelo inmediatamente después de reconstituirlo.

Cómo desecharlo: deseche la jeringa vacía y las agujas en el recipiente para desechar objetos punzantes.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la Información de prescripción de Cetrotide® (acetato de cetorelix para inyección) de 0.25 mg, visite www.EMDSeronoFertility.com, y hable con su profesional de la salud.

Pasos para la autoinyección de Cetrotide® (acetato de cetorelix inyectable) 0.25 mg




Preparar la jeringa y el lugar de la inyección



9. Tome la aguja de inyección con la marca gris y retire el envoltorio. Gire la aguja de la jeringa y retire la cubierta de la aguja.



10. Invierta la jeringa y empuje el émbolo hasta que todas las burbujas de aire hayan salido. No toque la aguja ni permita que esta toque ninguna superficie.

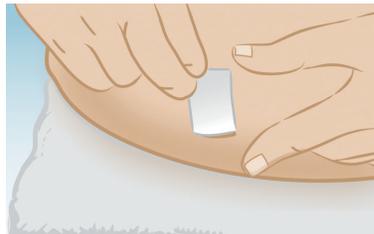

11. Elija un lugar de inyección en el área abdominal inferior, preferiblemente cerca del ombligo, pero al menos a una pulgada de distancia de este. Elija un lugar de inyección diferente cada día para minimizar la irritación local. Tome la segunda toallita con alcohol y limpie la piel en el lugar de la inyección. Deje que el alcohol se seque.



12. Inyecte la dosis prescrita de acuerdo con las indicaciones de su médico, enfermero o farmacéutico. Puede aplicar gaza en el lugar de la inyección.



13. Use la jeringa y las agujas solo una vez. Deseche la jeringa y las agujas inmediatamente después de su uso (coloque las cubiertas sobre las agujas para evitar lesiones). Se debe utilizar un contenedor de desechos médicos para desecharlas.

Indicación:

Cetrotide® (acetato de cetorelix para inyección) está indicado para la inhibición de los picos prematuros de Hormona Luteinizante (HL) en mujeres que se someten a estimulación ovárica controlada. Cetrotide® debe ser recetado por médicos con experiencia en tratamientos de fertilidad.

Información importante sobre los riesgos sobre el uso adecuado de Cetrotide® (acetato de cetorelix para inyección):

Los pacientes, las parejas y los cuidadores deben recibir instrucciones por parte de un profesional de la salud para

la preparación y la inyección de medicamentos antes de administrar tratamientos de fertilidad. Consulte el prospecto en la caja del medicamento para obtener más detalles. Use solo la dosis prescrita y póngase en contacto con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta acerca de la dosis o sobre cómo usar el producto. Informe sobre cualquier efecto secundario a su proveedor de atención médica. Las agujas y el producto deben desecharse en un recipiente de desecho adecuado según las instrucciones. No reutilice ni comparta las agujas.

Preguntas frecuentes

¿Cómo desecho correctamente los elementos utilizados para administrar el medicamento?

Las agujas, el vial y la jeringa utilizados deben desecharse en un recipiente para desechos objetos punzantes aprobado por la FDA inmediatamente después de su uso.

Si no tiene un recipiente para objetos punzantes, no tire agujas ni viales sueltos en el basurero de su casa. En su lugar, use un contenedor que:

- esté hecho de plástico resistente;
- se pueda cerrar con una cubierta hermética y resistente a los pinchazos;
- esté vertical y estable durante el uso;
- sea resistente a las filtraciones;
- esté debidamente etiquetado para advertir que contiene residuos peligrosos.

Para obtener más información, visite www.fda.gov/safesharpsdisposal.

¿Qué hago si he usado demasiado Cetrotide®?

En caso de exceder la dosis, póngase en contacto con su médico de inmediato para comprobar si se requiere un ajuste del procedimiento de estimulación ovárica adicional.

¿Puedo usar mi medicamento si lo dejé afuera en un automóvil y hacia frío o calor?

Cetrotide® debe almacenarse en un lugar protegido de la luz y en el refrigerador, entre 36 °F y 46 °F.

Para obtener más información sobre cómo almacenar el medicamento, llame al soporte de Fertility LifeLines™ al 1-866-538-7879 o comuníquese con su proveedor de atención médica.



MÁS APOYO

Para obtener más materiales de apoyo, visite EMDSeronoFertility.com.

Consulte la Información de prescripción completa (PI) y el Folleto para el paciente que se encuentran en la caja del producto para obtener detalles del producto.

©2022 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, o sus filiales. Todos los derechos reservados. EMD Serono es la empresa de salud de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, en los EE. UU. y Canadá. Cetrotide es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, o sus filiales. US-CET-00038 05/23

